

星光療癒棒

Mandala Wand



星光曼陀羅應用程式使用手冊

Mandal Star App User Manual



Version 2.0


Date 2021-01-10

使用產品前請詳細閱讀使用手冊

目錄

	頁數
1. 安卓設備要求	2
2. 移動應用程式最終用戶許可協議	3
3. 安裝和操作說明	5
4. 星光曼陀羅應用程式主頁介面	8
5. 應用程式設置	9
5.1 新用戶設置	9
5.2 應用程式啓動	10
5.3 平板電腦／手機藍牙連接設置	11
5.4 應用程式設定	12
5.4.1 藍牙連接設置	12
5.4.2 一般設定	13
5.4.3 曼陀羅全方位掃描儀設定	14
5.4.4 光之韻律煉金儀設定	14
5.4.5 應用程式啓動狀態	15
6. 曼陀羅療癒棒	16
6.1 資料庫	16
6.1.1 雷射與標量波功能設置	18
6.1.2 營養光設置	18
6.1.3 測試掃描	19
6.2 掃描	20
6.2.1 測試掃描	20
6.2.2 資料庫列表-自選要掃描的資料庫	21
6.2.3 綜合掃描	22
6.2.4 多重掃描	25

6.3	自訂控制	28
6.4	預設程式	29
6.4.1	基本預設程式資料庫	29
6.4.2	創建預設程式	30
6.4.3	預設程式播放模式	32
6.5	線上預設程式	34
6.5.1	下載預設程式	35
6.5.2	上傳預設程式	36
6.6	資料同步	37
6.6.1	上傳頻率	38
6.6.2	上傳預設程式	39
6.7	音頻模式	41
6.7.1	雷射和標量波脈衝/閃爍設置	41

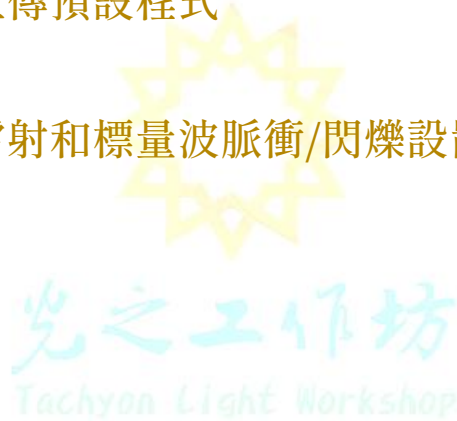

1. 安卓設備要求

星光曼陀羅應用程式只能在安卓手機或平板電腦上運作。

最低要求：

作業系統：安卓作業系統

安卓版本：安卓 8.0 或更高

其他：配有藍牙和 WIFI 功能



2. 移動應用程式最終用戶許可協議

在下載或使用星光曼陀羅 - Mandala Star 應用程式之前，請仔細閱讀本移動應用程式使用者授權合約（End-User License Agreement - EULA）。此 EULA 合約規範應用程式的使用準則，使您有權限可以訪問光之曼陀羅資料庫（Light Mandalas library），並透過移動設備控制曼陀羅系列產品。您於下載及使用該應用程式時，即表示您同意此 EULA 合約。

1. 授權合約：Light Mandalas Co., Ltd. 將遵照 EULA 合約授權使用者可撤銷、非專用以及不可轉讓的有限許可權，僅用於您個人和內部業務目的之下載、安裝和使用該應用程式
2. 您的帳戶：您需擁有 Light Mandalas 帳戶才能使用該應用程式。
3. 對此 EULA 合約的更改：Light Mandalas 保留修改此 EULA 的權利。您在 Light Mandalas 發佈本 EULA 更改通知後繼續使用該應用程式，表示您同意更新的條款。
4. 不包括維修和支援服務：Light Mandalas 可以隨時針對應用程式進行更改、更新或優化。Light Mandalas 可以為該應用程式提供維修和支援，但沒有義務向您提供此類服務，並且可以隨時終止此類服務，恕不另行通知。您承認 Google 有義務提供與該應用程式相關的任何維護和／或支援服務。
5. 同意：您同意不會以損害或妨害他人使用移動應用程式的方式使用或鼓勵他人使用該應用程式。
6. 隱私：Light Mandalas 不會從您的應用程式中收集您的資訊。應用程式內部的資訊將是私有的。

7. 無保固：您自行承擔使用該應用程式的風險。該應用程式是按「原樣」和「可用」的基礎提供的。Light Mandalas 明確拒絕任何形式的所有保證。
8. 暫停和終止該應用程式：Light Mandalas 保留隨時暫停或終止您對應用程式訪問的權利。
9. 智慧財產權：如果協力廠商聲稱該應用程式或您對應用程式的擁有和使用侵犯了協力廠商的智慧財產權，Light Mandalas 將全權負責調查、辯護、解決和解除任何此類智慧財產權侵權索取。




3. 安裝和操作說明

用戶可以在「Google Play 商店」或「華為商店」下載星光曼陀羅應用程式。

1. 打開「Google Play 商店」或「華為商店」應用程式
2. 在「華為商店」搜索欄中輸入「星光曼陀羅」

在「Google Play 商店」搜索欄中輸入「Mandala Star」

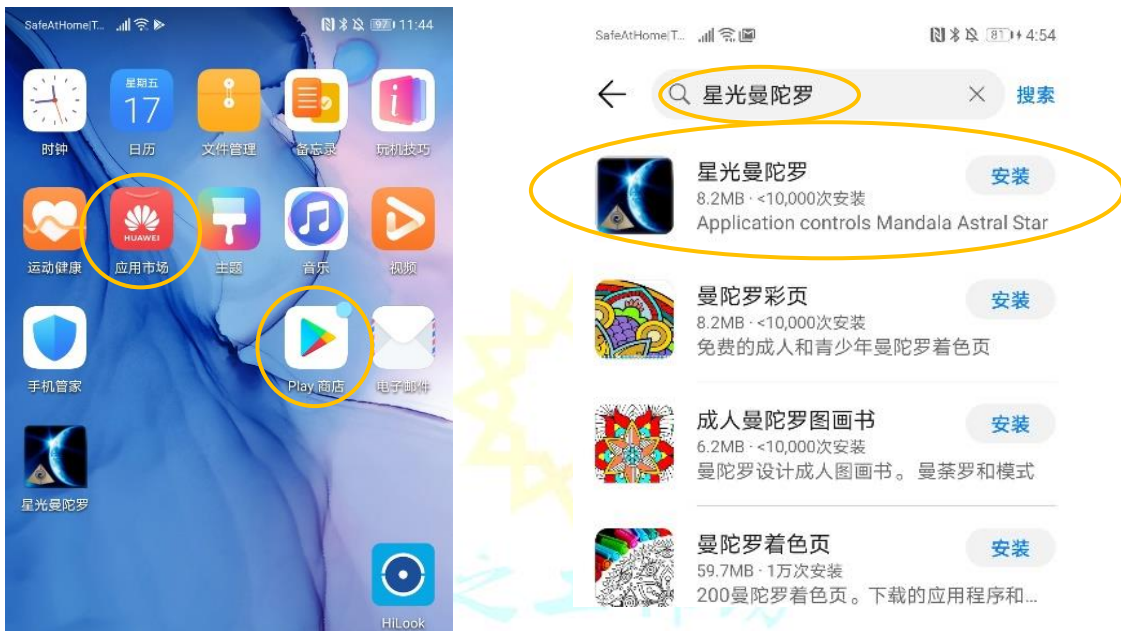

3. 點擊安裝以安裝應用程式




4. 允許應用程式許可權


A. 點擊平板電腦或手機設置



B. 點擊「應用」，然後點擊應用管理，搜索「星光曼陀羅」應用程式。

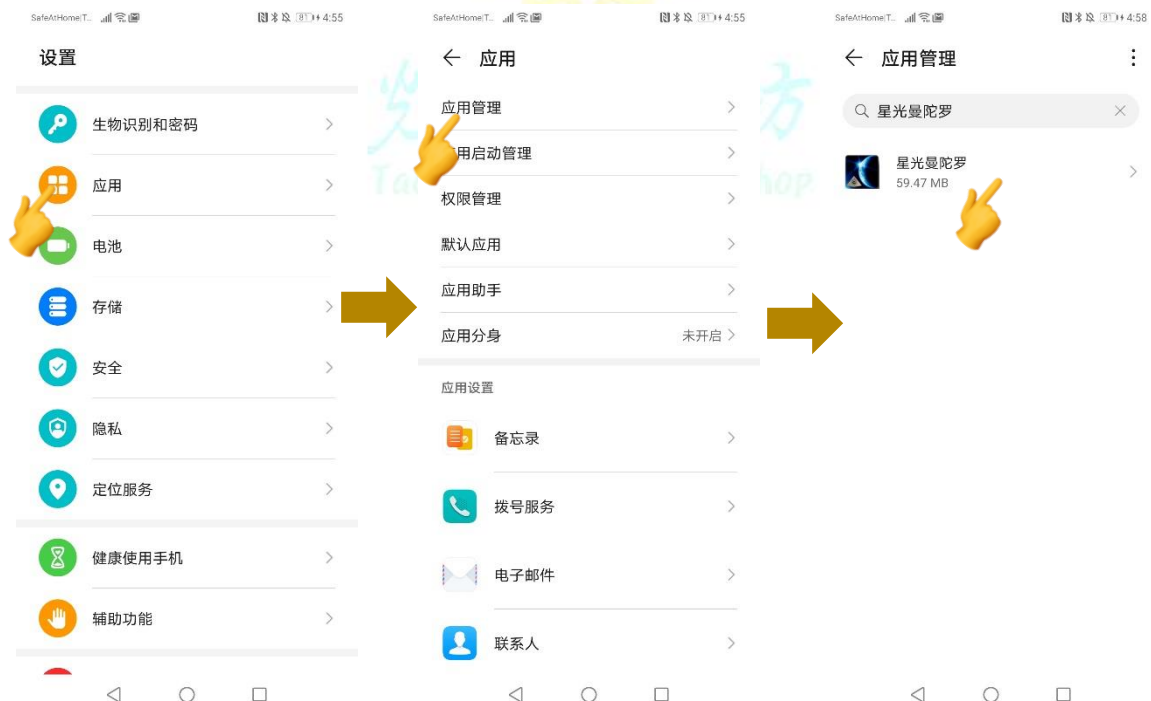

C. 點擊「許可權」，允許「儲存」許可權。

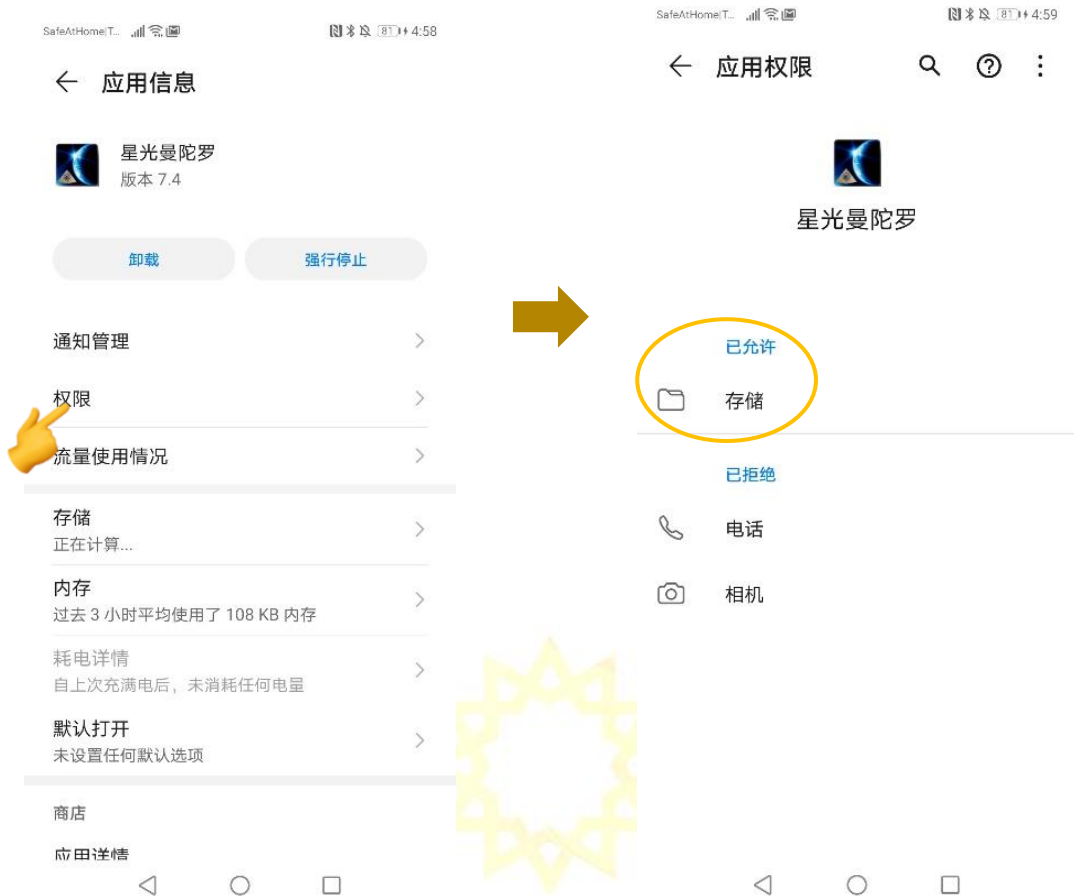

4. 星光曼陀羅應用程式主頁介面



1 - 7 是不同的曼陀羅設備程式

使用者可以使用特定的程式來操作特定的設備。

1. 零點之星光能儀
2. 紫紅光能儀
3. 全方位掃描儀
4. 身心靈整合療法 PSI

Psycho Spiritual Integration

- 必須購買 PSI 資料庫方可使用此程式
- 必須搭配掃描器使用

5. 光之韻律煉金儀
6. 重力儀
7. 曼陀羅星光療癒棒

8. 資訊：提供用戶最新的應用程式更新資訊。

9. 用戶：創建新的用戶個人資料

10. 設定：應用程式設定—藍牙設備配對、掃描器設定、煉金儀設定、語言設定、資料庫更新、釋放啟動碼


11. 啟動：使用啟動碼啟動應用程式

12. 退出：退出應用程式


5. 應用程式設置

5.1 新用戶設定

打開應用程式後，將會進入「創建新使用者」介面。輸入用戶個人資料，點擊確認創建新的使用者資料。可以點擊圖片插入喜歡的圖片。用戶名將顯示在主頁上。

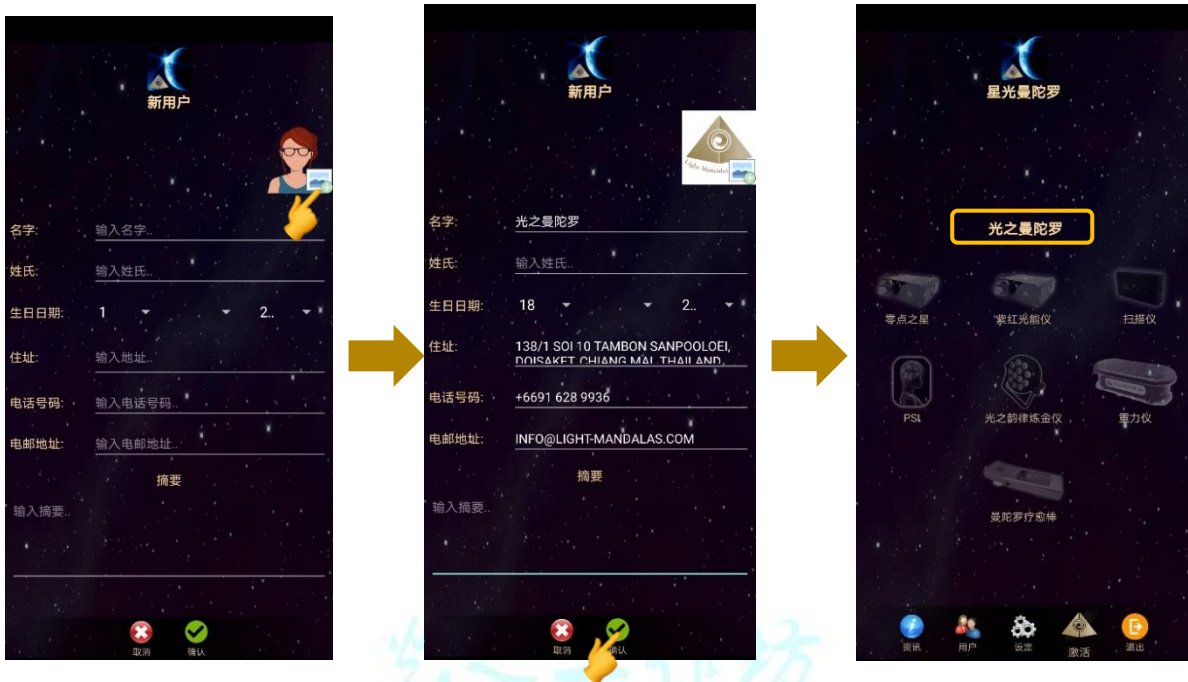


用戶也可以自行添加新用戶。用戶 → 新用戶

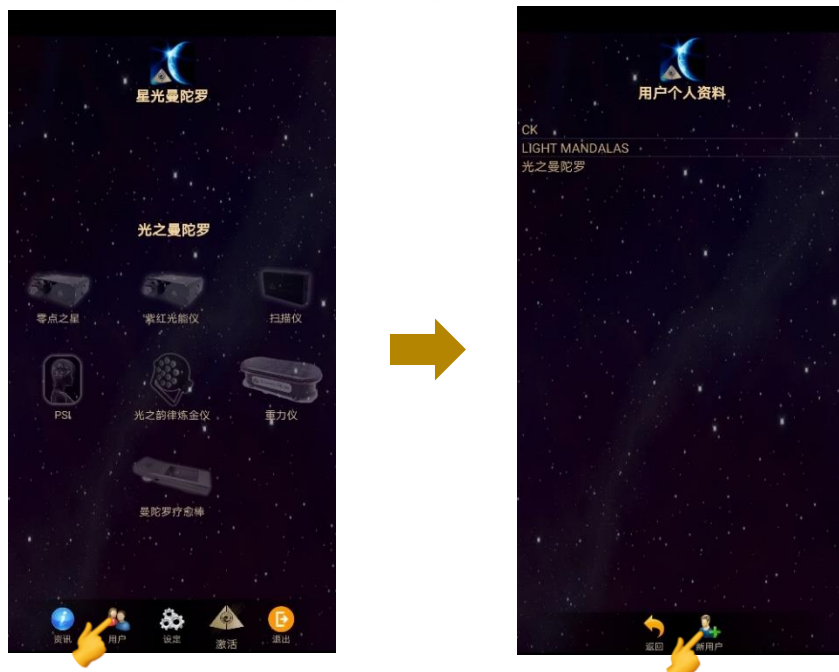

5.2 應用程式啓動

點擊「啓動」以啓動應用程式。輸入啓動碼，然後點擊確認。

**使用者可以向本公司索取啓動碼*

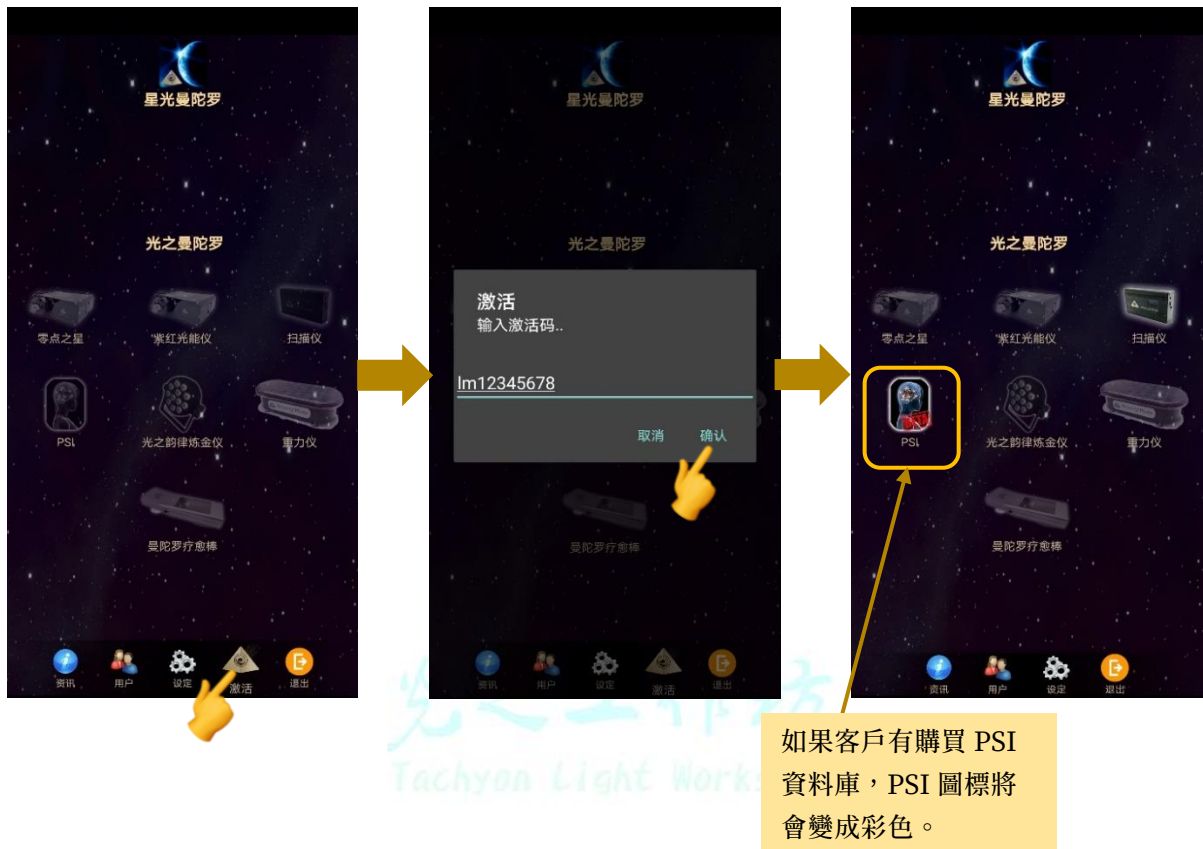

5.3 平板電腦/手機藍牙連接設置

1. 在安卓設備中，轉到「設置」打開藍牙，然後點擊「掃描」以掃描設備名稱。



2. 當設備名字出現時，點擊它並輸入密碼：「1234」，然後點擊 OK 進行配對。



5.4 應用程式設定

5.4.1 藍牙連接設置：

1. 點擊星光曼陀羅應用程式設定，點擊您所要配對的設備，並選擇特定設備名字，再點擊返回。（範例為配對星光療癒棒）



2. 在應用程式設定中配對了設備名字後，主頁中的設備圖示將變成彩色。（範例為配對星光療癒棒）



5.4.2 一般設定



数据库更新（需要连网）



语言设定

5.4.3 曼陀羅全方位掃描器設定

掃描深度:

1. 普通掃描：當進入藍或綠色狀態時才進行掃描
2. 深度掃描：當進入綠色狀態時才進行掃描

顏色/頻率掃描:

顏色掃描 – 零點之星和紫紅光能儀：
打勾：不同顏色的預設程式掃描結果
不打勾：只有白色的預設程式掃描結果

頻率掃描 – 光之煉金儀：

打勾：不同的光脈衝頻率預設程式掃描結果
不打勾：光脈衝預設頻率預設程式掃描結果

頻率掃描 – 曼陀羅療愈棒：

打勾：不同顏色的預設程式和雷射結果
不打勾：沒有顏色的預設程式和所有雷射打開 (FULL)



掃描選擇:

1. 快速掃描：根據設定次數進行掃描。
2. 生物訊息場掃描：根據身體及能量和諧狀態進行掃描。

掃描次數：

設置快速掃描的掃描次數

優先程度(%)：

重點關注的掃描結果的優先程度

5.4.4 光之煉金儀設定

預設頻率：

使用者可以再這裡設置預設頻率。

如果設定中的顏色/頻率掃描是不打勾的情況下，光之韻律煉金儀的掃描結果的頻率將會根據這裡所設置的預設頻率為準。



生物反饋配對：

生物反饋功能開啓。


5.4.5 應用程式啓動狀態



每個啓動碼最多供 5 台移動設備使用（平板電腦或手機）。如果啓動碼已經用於啓動 5 台不同的移動設備，並且希望在第 6 台平板或手機上使用該啓動碼，則必須從先前已啓動的任一臺移動設備中釋放該啓動碼。

6 曼陀羅療癒棒

在星光曼陀羅應用程式的主頁裡點擊曼陀羅療癒棒的圖示以轉到曼陀羅療癒棒主頁。

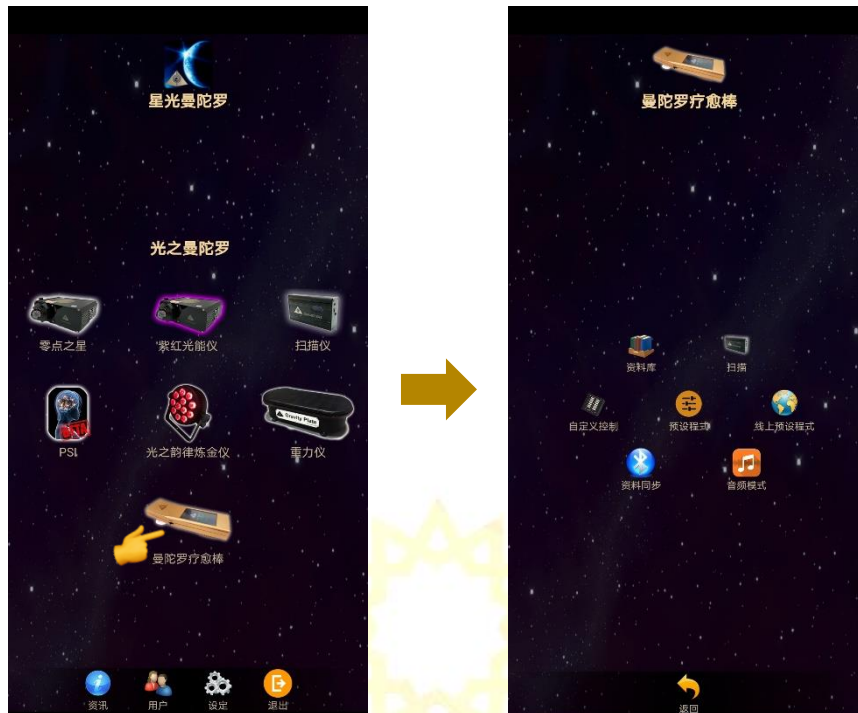

光之工作坊
Tachyon Light Workshop

6.1 資料庫

如要播放資料庫內的預設程式，可以直接點擊任何一個子資料庫，然後選擇要播放的頻率。



用戶可以從選擇圖庫下拉清單中切換到其他圖庫。



6.1.1 雷射與標量波功能設置

使用者可以點擊底部的雷射或標量波圖示以播放雷射或標量波。



6.1.2 營養光設置

使用者還可以在播放頻率時選擇播放營養光。點擊並按住頻率名稱，然後選擇要播放的顏色。





6.1.3 測試掃描


這功能可以協助使用者透過自身的身體和諧狀態掃出他們當下最優先/重要的資料庫，然後使用者可以直接點按播放掃描結果重要資料庫裡的頻率。

* 使用此功能前，請記得將掃描儀與平板電腦或手機進行配對。

在 app 設定中設置好掃描器後，“測試掃描”的圖示將會變為彩色



提醒用戶打開掃描儀

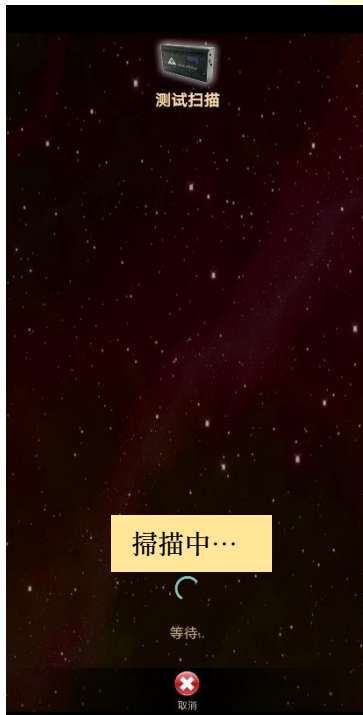

在此掃描中此資料庫被掃描的次數。
* 掃描次數越多代表該專案在此掃描中越重要，以此類推。


灰色專案在此掃描中表示次要的資料庫
* 用戶可以在 app 的設定中設置在掃描中掃出“重要”資料庫的百分比。

6.2 掃描

如果使用者不確定當前哪個資料庫或頻率適合他們，則可以使用掃描功能通過使用者自身的身體和諧狀態掃出優先／重要資料庫，並從掃描結果中創建已掃描預設程式。

6.2.1 測試掃描

這功能可以協助使用者透過自身的身體和諧狀態掃出他們當下最優先／重要的資料庫，然後使用者可以從掃描結果中選擇重要的資料庫以繼續進行進一步的掃描。

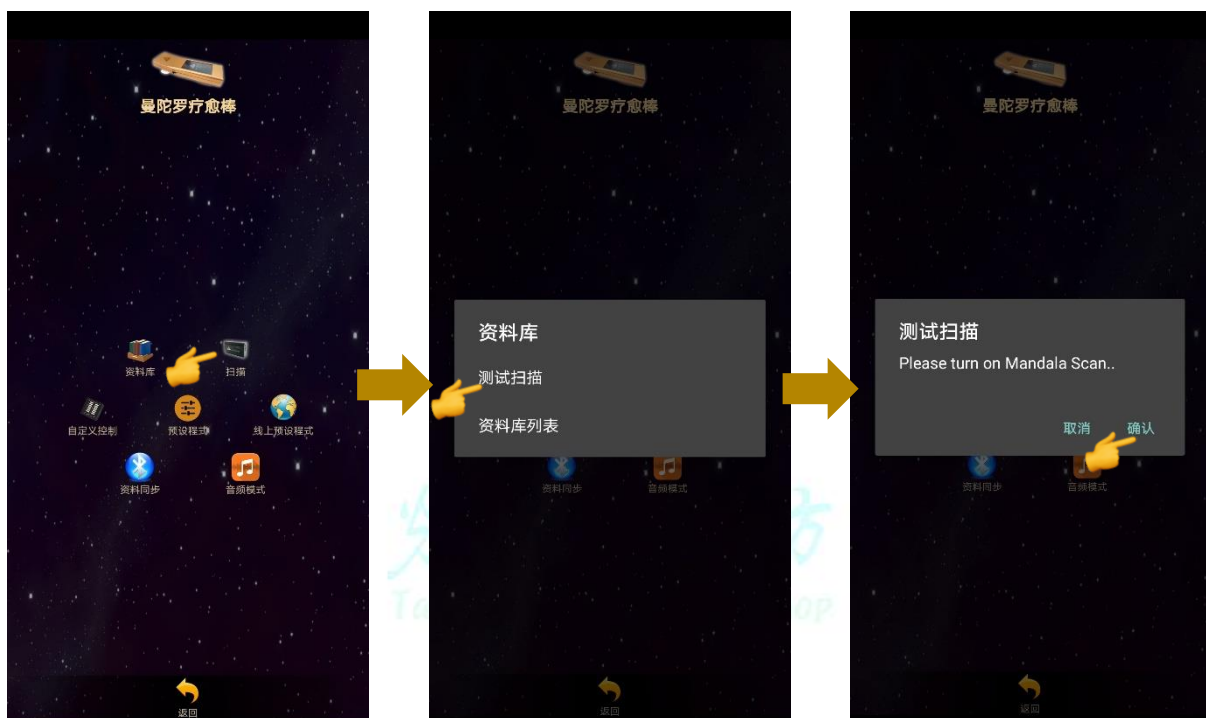



6.2.2 資料庫清單-自選要掃描的資料庫


此模式允許使用者手動選擇要掃描的特定資料庫。



6.2.3 綜合掃描

選擇要掃描的資料庫，然後點按「綜合掃描」以進行進一步掃描。

使用此功能前，請記得將掃描儀與平板電腦或手機進行配對。

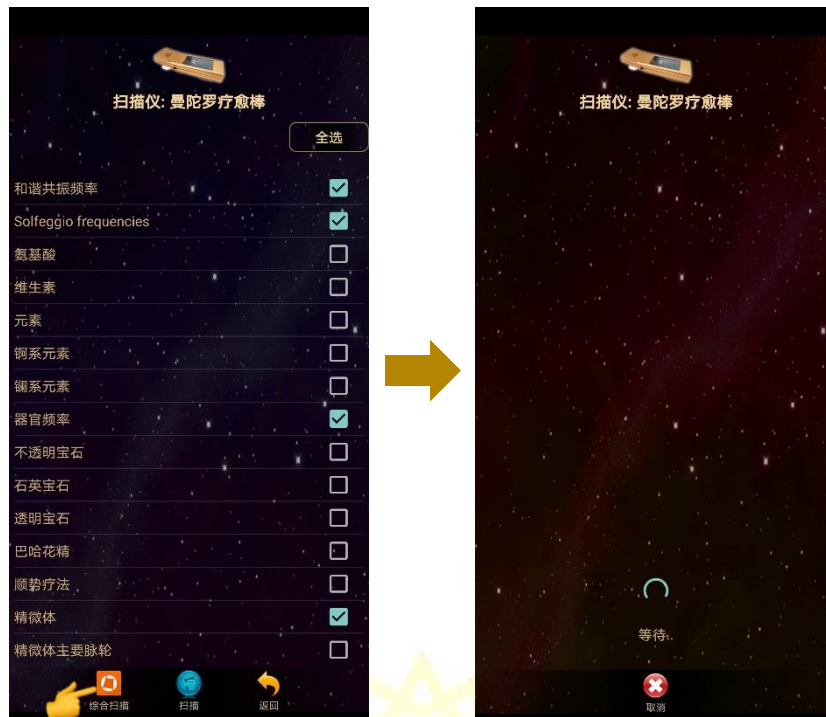

在綜合掃描結果裡創建已掃描預設程式：

如果「顏色/頻率掃描 (Colour/Freq. Scan)」在「應用程式設置」中是「不勾選」，掃描將以預設模式運作，最終所有掃描結果專案均不顯示顏色（營養光），並且所有雷射均打開（FULL），包括標量波。



如果「顏色/頻率掃描 (Colour/Freq. Scan)」在「應用程式設置」中是「勾選」，最終所有掃描結果的專案將以不同的顏色 (營養光) 和不同的雷射呈現。



掃描結果將在掃描完成後顯示。然後點按在「儲存預設程式」。選擇您要保存的項目，然後再次點按「儲存預設程式」，將其保存到已掃描預設程式中。





存檔給此用戶
僅此使用者可以在“已掃描預設程式資料庫”裡查看和播放此“已掃描預設程式”。



存檔給所有用戶
所有使用者都可以在“已掃描預設程式資料庫”裡查看和播放此“已掃描預設程式”。


保存預設程式後，點按「放棄」，然後點按「確認」以返回曼陀羅療癒棒主頁。



6.2.4 多重掃描

選擇所有資料庫或特定資料庫，然後點按掃描。

* 使用此功能前，請記得先將掃描儀與平板電腦/手機進行配對連接

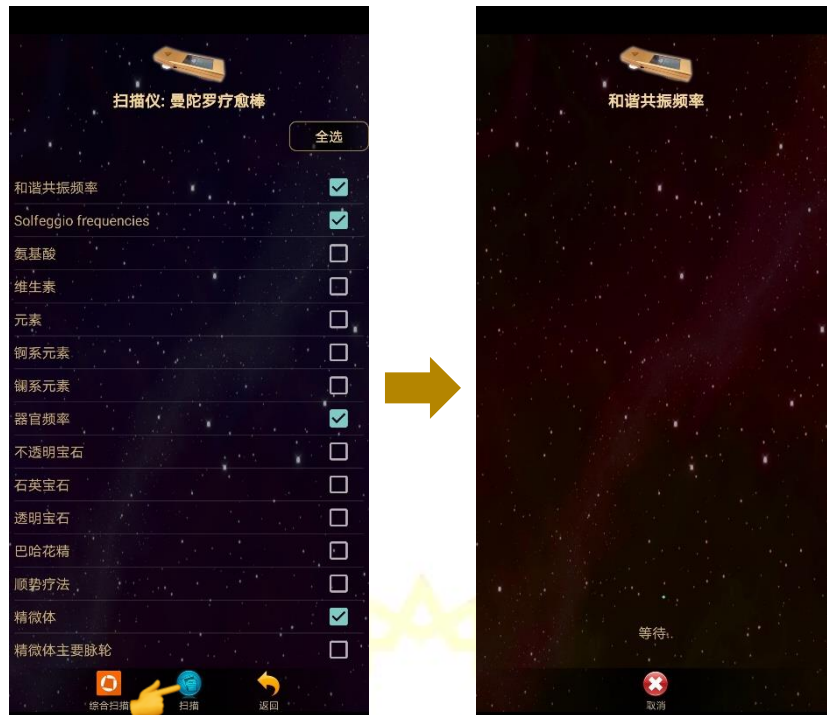

在多重掃描結果裡創建已掃描預設程式：

掃描結果將在掃描完成後顯示。

a. 在資料庫中選擇要保存的專案：

在掃描結果中點按任何資料庫以選擇要保存的特定項目。

- b. 選擇要保存的資料庫：
 在這種保存方法中，將保存每個選定資料庫中的所有專案，包括次要的項目（灰色項目）。



保存預設程式後，點按「放棄」，然後點按「確認」以返回曼陀羅療癒棒主頁。



6.3 自訂控制

在此模式裡，使用者可以自訂其頻率和燈光顏色。



6.4 预设程式

點按预设程式以進入预设程式主頁。



6.4.1 基本預設程式資料庫

使用者可以選擇在此模式下播放由 Light Mandalas 團隊所創建和共用的基本預設程式。



點擊任何預設程式以顯示選項。

點按“播放”進入播放模式以直接播放預設程式。

點按“資訊及下載”以顯示有關此預設程式的更多資訊並下載。

下載到預設程式資料庫

預設程式頻率清單

氨基酸名稱	頻率 (Hz)	強度	時長
丙氨酸	4535.00	[FULL]	0:9
精氨酸	2296.00	[FULL]	0:9
天冬酰胺	38427.00	[FULL]	0:9
天冬氨酸	464.00	[FULL]	0:9
半胱氨酸	4357.00	[FULL]	0:9
DL-苯丙氨酸	879542.00	[FULL]	0:9
谷氨酸	3624.00	[FULL]	0:9
谷氨酰胺	97176.00	[FULL]	0:9
甘氨酸	2316.00	[FULL]	0:9
組氨酸	4431.00	[FULL]	0:9
羧脯氨酸	43104.00	[FULL]	0:9
異亮氨酸	621.00	[FULL]	0:9
左旋肉碱	69969.00	[FULL]	0:9
亮氨酸	4226.00	[FULL]	0:9
賴氨酸	4236.00	[FULL]	0:9
蛋氨酸	4361.00	[FULL]	0:9
茶丙氨酸	3374.00	[FULL]	0:9
脯氨酸	5885.00	[FULL]	0:9
絲氨酸	7213.00	[FULL]	0:9
牛磺酸	89269.00	[FULL]	0:9
蘇氨酸	3262.00	[FULL]	0:9
色氨酸	2458.00	[FULL]	0:9
酪氨酸	3264.00	[FULL]	0:9
精氨酸	5339.00	[FULL]	0:9

6.4.2 創建預設程式

用戶可以自行創建/自訂自己的預設程式。當用戶完成了預設程式設置後，可以點擊「創建」保存它。

輸入預設程式名字

輸入預設程式描述

資料庫選擇
下拉清單

單一添加頻率

同時一起添加多個頻率

時間設定:
設置每個頻率的播放時間

創建/儲存預設程式

a. 營養光和雷射功能設置：

用戶可以長按任何頻率以更改營養光或雷射功能。



b. 頻率播放時間設置：

用戶可以通過點擊「時間設定」以選擇「單項設置」或「全部設置」的方式來設置每個頻率的播放時間。設置時間後，用戶可以再次點擊「時間設定」進行儲存。



6.4.3 預設程式播放模式


a. 單一預設程式選擇：

在預設程式主頁中點擊您要播放的任何預設程式。然後點擊「進入」以進入「播放模式」。



b. 多項預設程式選擇：

選擇多項預設程式以創建一個播放清單一起播放。使用者可以從已掃描預設程式，自創建預設程式和已下載的基本預設程式中選擇預設程式。

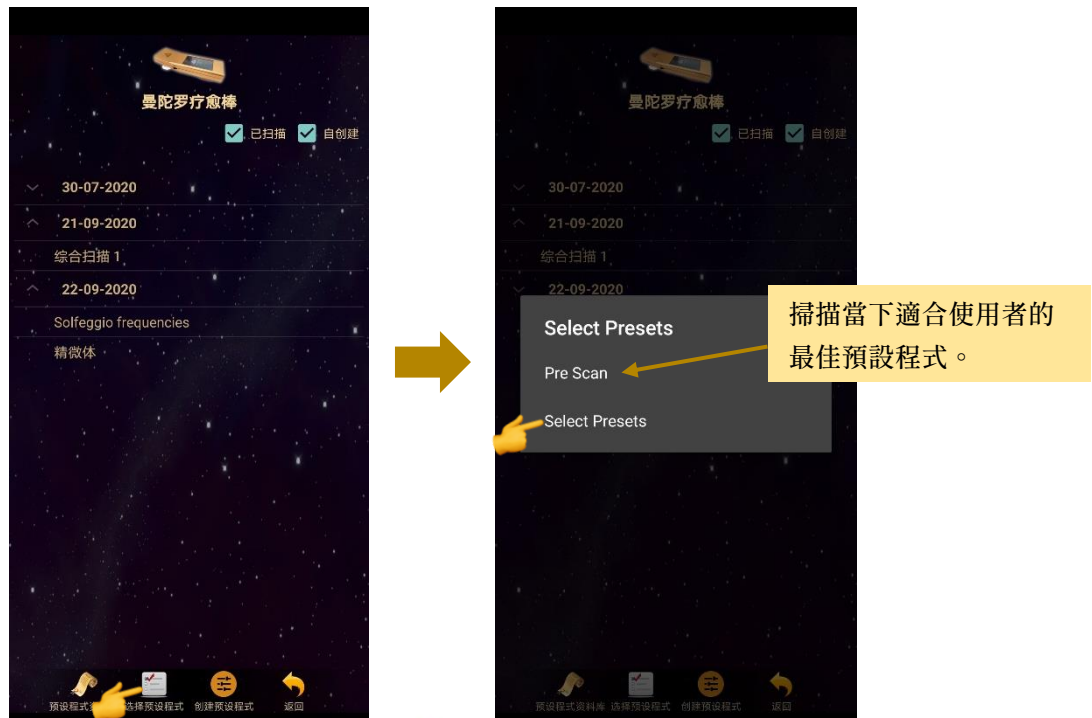

c. 播放模式:

點擊「播放」以播放已創建的播放清單。

勾选“持续重播”以重复播放此播放清單。

勾选“重播次數”以設置重播次數。
在此例子中，重播次數是 2。這意味著播放清單將重複播放 2 次後停止。

“間隔”是每個重播之間的間隔時間。
在此例子中，每個重播之間的間隔是 3 秒鐘。這意味著播放清單播放完畢後將停止 3 秒鐘後。

重置播放清單

如果需要重新創建播放清單，可以點按「返回」回到上一頁。

放棄：
播放模式將立即停止

保留：
正在播放的頻率將繼續播放。

6.5 線上預設程式

使用者可以在「線上預設程式」模式中下載其他使用者共用的預設程式。用戶也可以把他們的預設程式上傳到線上與其他用戶共用。

6.5.1 下載預設程式



要下載線上預設程式，點擊用戶名字以查看他們共用哪些預設程式。然後點擊要下載的預設程式以獲取更多資訊，然後選擇「下載」。




6.5.2 上傳預設程式

若要上傳預設程式，點擊「我共用的預設程式」，然後點擊「添加」，從您之前創建的預設程式中選擇您要上傳的預設程式。




若要刪除共用預設程式，點擊該預設程式，然後選擇「刪除」。

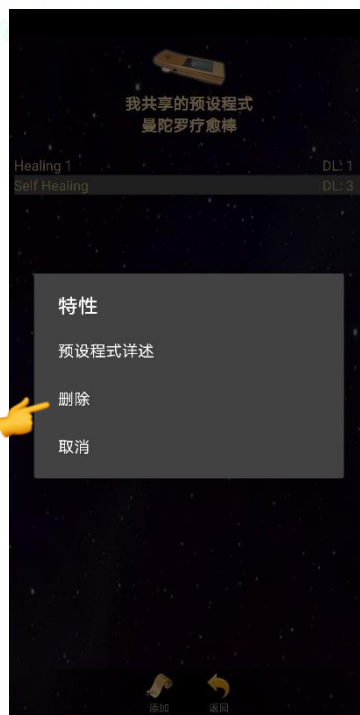

6.6 資料同步


在此模式下，使用者可以將自己喜歡的頻率或預設程式從「星光曼陀羅應用程式」上載／同步到曼陀羅療癒棒。因此，將來用戶可以在不使用任何安卓設備的情況下進行播放。

在使用此模式前，請確保將曼陀羅療癒棒設置為藍牙模式。

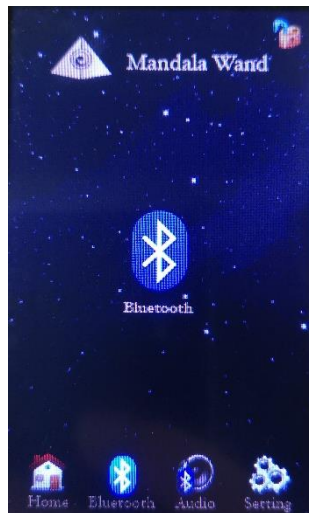


曼陀羅療癒棒 LCD 螢幕 – 藍牙模式

點按「資料同步」，然後使用者可以選擇上傳／同步頻率或預設程式。

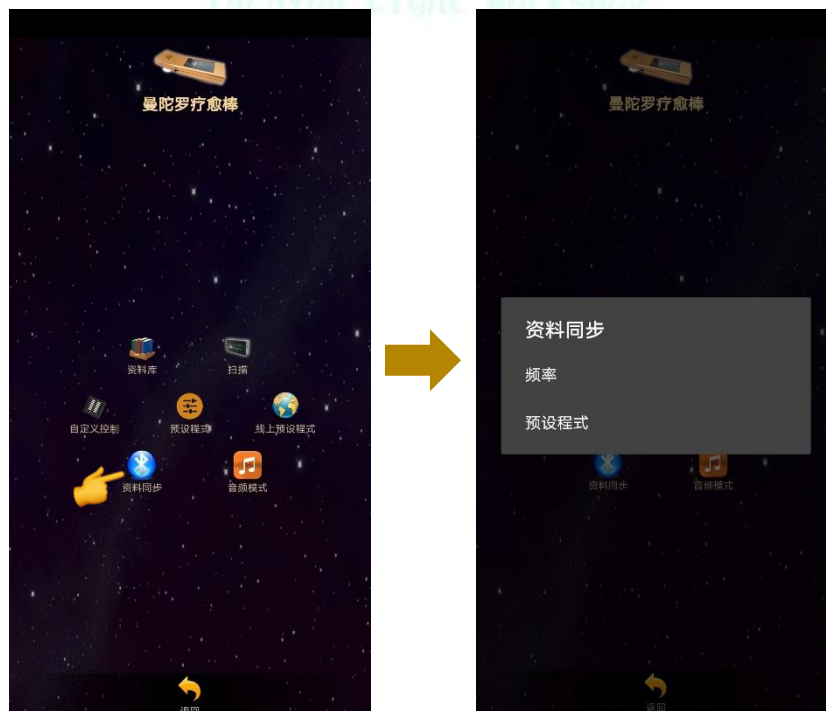


6.6.1 上傳頻率

要上傳頻率，請選擇「頻率」以進入「資料同步頻率首頁」。

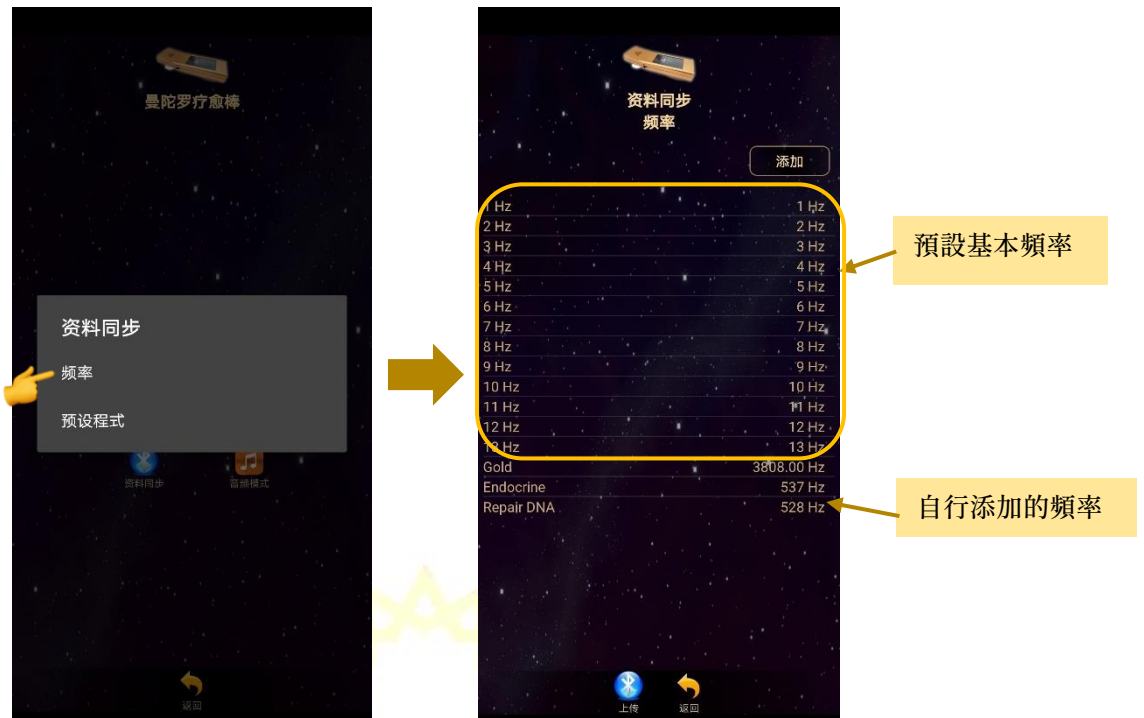

若要添加頻率，請點按「添加」


*請注意！上傳到曼陀羅療癒棒的頻率限制為最多 20 個項目。

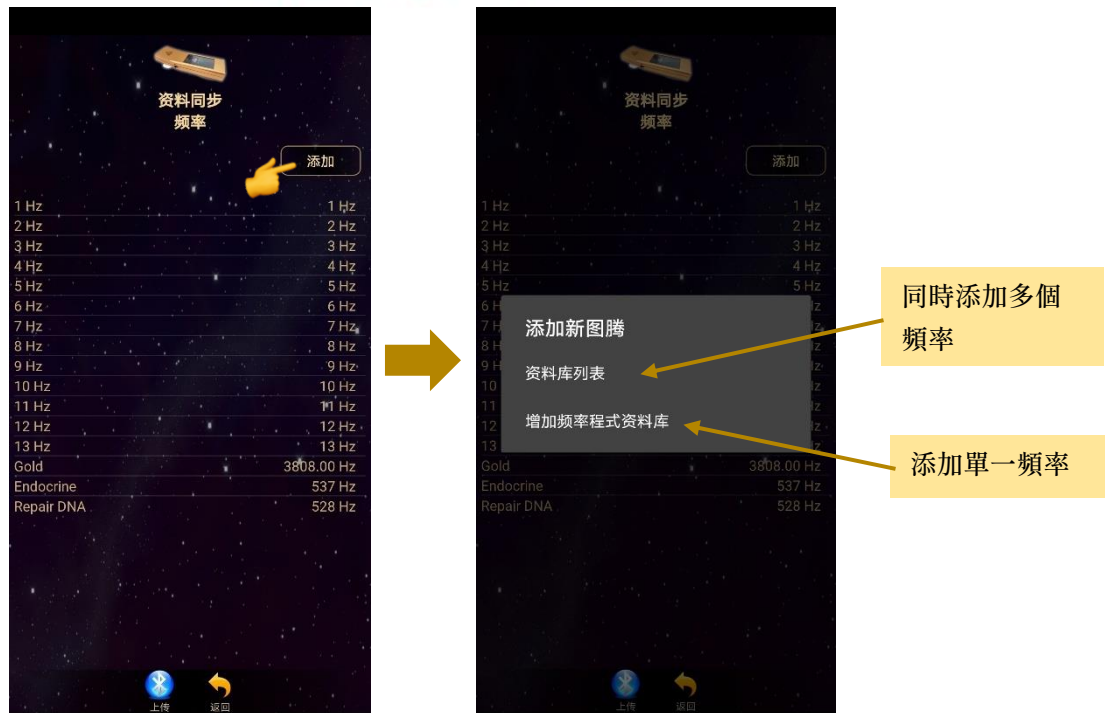

如果使用者希望編輯或刪除頻率，請點按該頻率。




將所需的頻率添加到清單後，點按「上傳」以將「頻率清單」上傳到曼陀羅療癒棒。

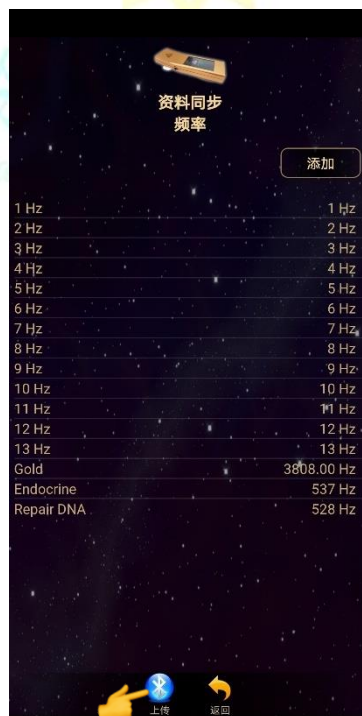

6.6.2 上傳預設程式

要上傳預設程式，請選擇「預設程式」以進入「資料同步預設程式首頁」。

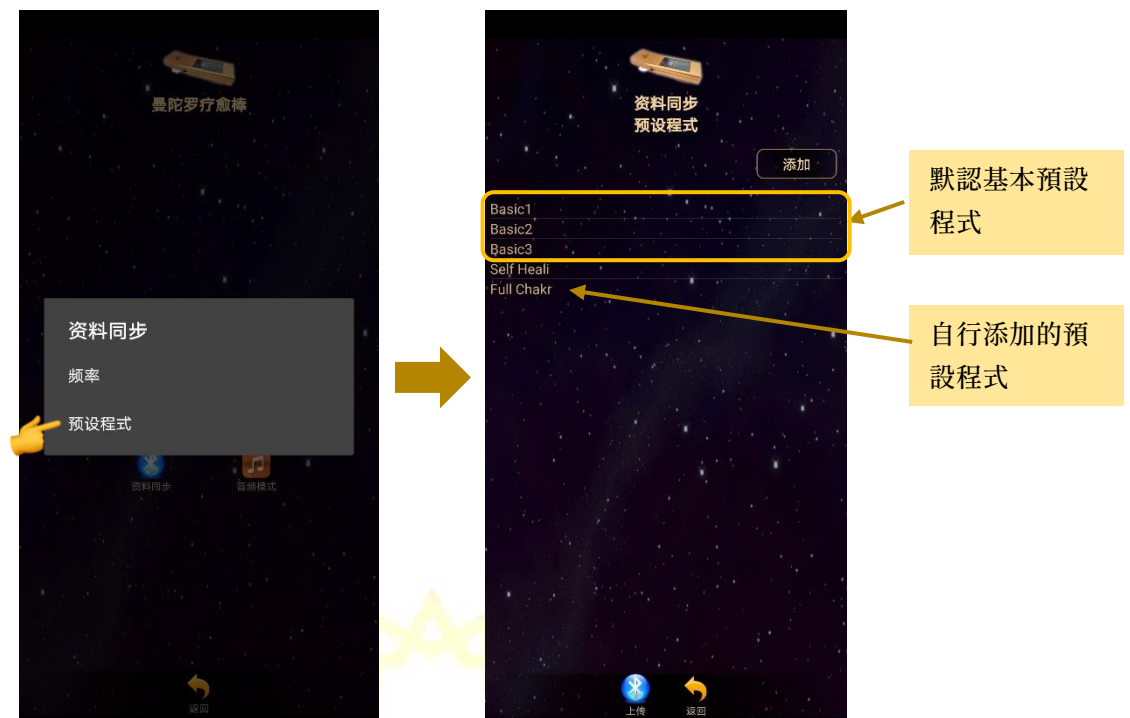

若要添加預設程式，請點按「添加」

**請注意！上傳到曼陀羅療愈棒的預設程式限制為最多 7 個，而且每個預設程式最多只能有 20 個頻率專案。*



如果使用者希望編輯或刪除頻率，請點按該頻率。



將所需的預設程式添加到列表後，點按「上傳」以將「預設程式列表」上傳到曼陀羅療癒棒。




6.7 音訊模式

6.7.1 雷射和標量波脈衝/閃爍設置

在此模式下，使用者可以從平板電腦添加和播放音樂。使用者可以同時享受脈衝雷射和音樂療法。雷射和標量波將根據音樂播放而跳動。


在使用此模式前，請確保將曼陀羅療癒棒設置為藍牙音訊模式，並已將耳機插入曼陀羅療癒棒。（有關耳機設置的說明，請參閱《曼陀羅療癒棒用戶手冊》）

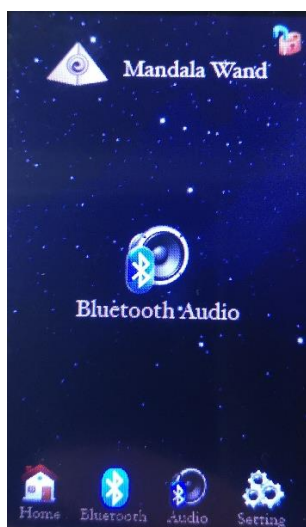

曼陀羅療癒棒 LCD 螢幕 – 藍牙音訊模式


然後按照以下步驟操作：

1. 轉到安卓手機設定，打開藍牙並點按掃描以掃描「耳機名字」。

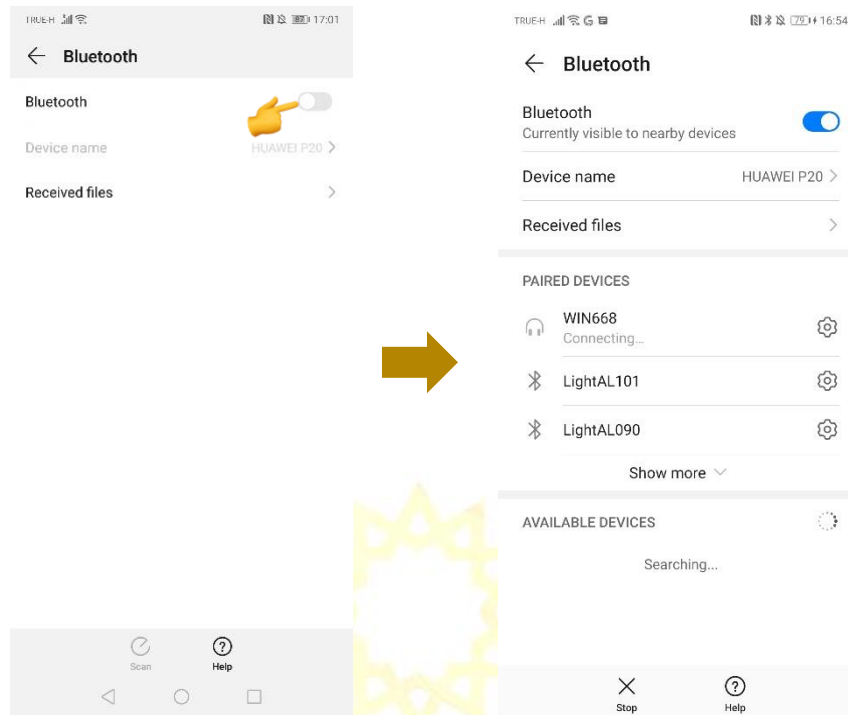


2. 當耳機名字「XY-BT」出現時，點按它，然後選擇「配對」進行配對。

* 使用者只需在首次使用耳機時需要配對耳機名字。往後耳機名字將保存在配對設備清單中。

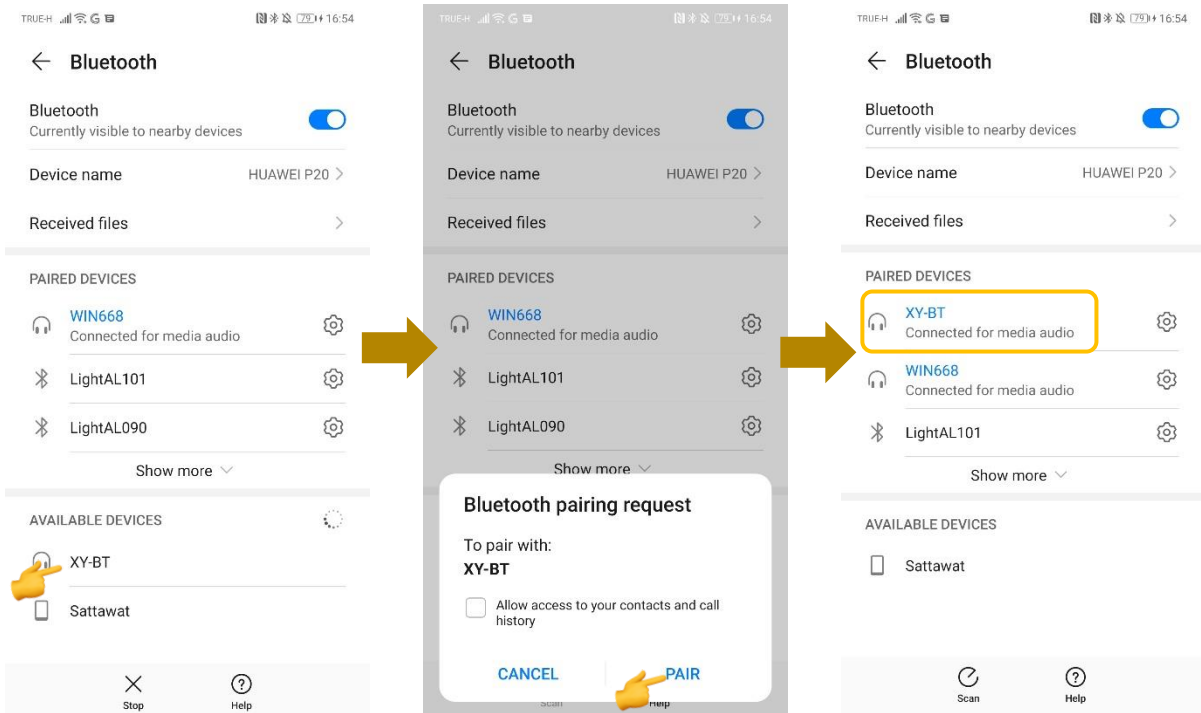

3. 返回星光曼陀羅應用程式-曼陀羅療癒棒主頁，在「音訊模式」下，按一下「添加」以添加您要播放的音樂，然後點按音樂名字以播放它。

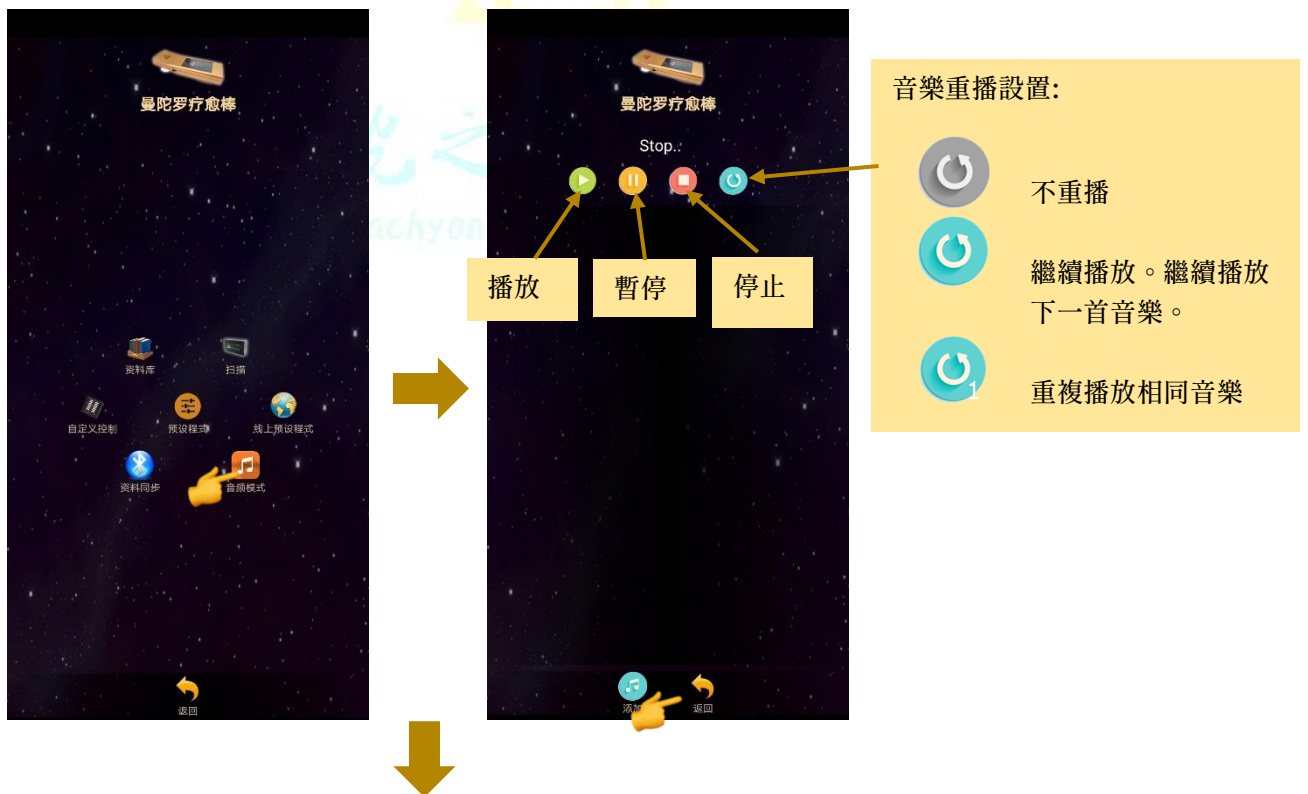



播放音樂時，使用者可以轉到「預設程式資料庫」播放預設程式或從「頻率資料庫」播放特定的頻率。現在，雷射和標量波會根據音樂播放而脈動／閃爍。

光之工作坊
Tachyon Light Workshop